
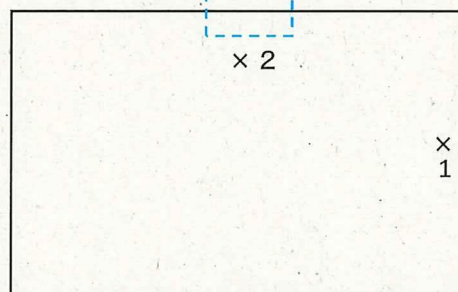
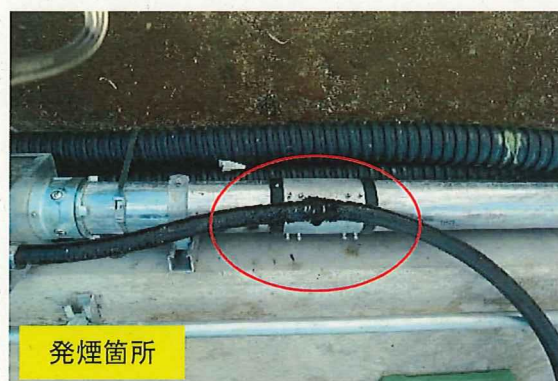


放射線サーベイ記録

測定目的	状況確認サーベイ	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	水処理建屋（屋外）	測定者	保安班
測定計画	放射線測定依頼書に基づく測定記録	測定器	F1-HS-093 F1-ICW-269
測定日時	2020/2/5 11:10 ~ 11:20		

×：空間線量当量率

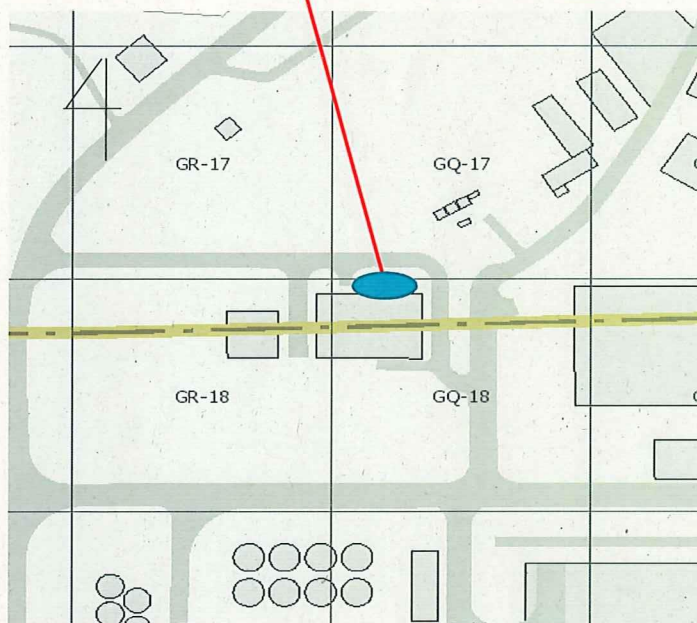

測定箇所※	線量当量率(mSv/h)
	1cm線量当量率
BG	0.001
1	0.001
2	0.001

※地面から1m高さで測定

承認	審査	作成